

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2024.01.08

试剂批号: 22401031


配套稀释液批号: 22312082

试剂规格: 1L、5L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	PZH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.02L	5.03L	5.02L	5.02L	√
pH值	25±1℃时, 7.00±0.50。	检测温度: 23.0℃				√
		7.15	7.14	7.15	7.15	
空白值	RBC ≤ 0.03 × 10 <sup>12</sup> /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT ≤ 10 × 10 <sup>9</sup> /L	0	0	0	0	√
检测本	检测本	检测本				检测本
检测本	检测本	检测本				检测本

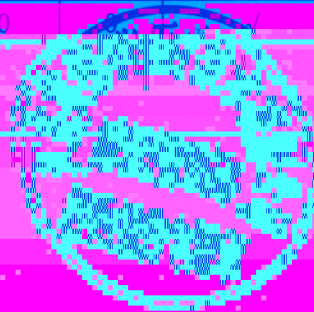

检测本

检测本

检测本

检测本

检测本

检测本